



## İşitme cihazımız.

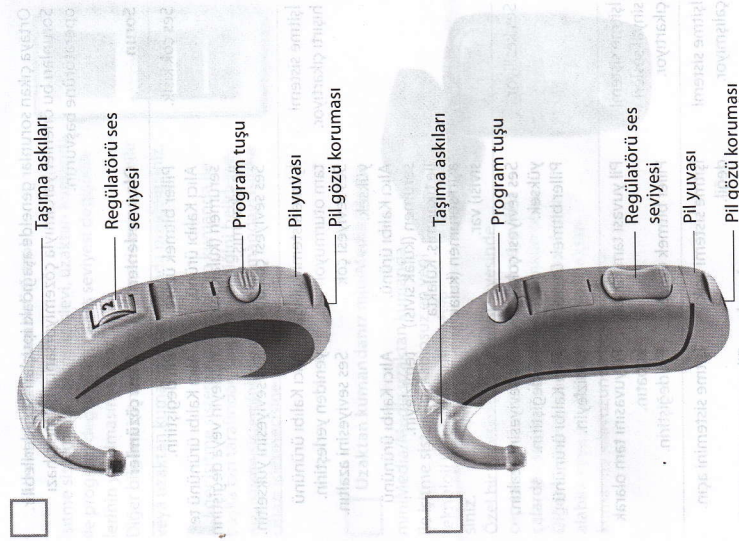

**Yan işaret:** Kırmızı yan işaret = sağ kulak  
Mavi yan işaret = sol kulak


FCC ID: WU7-WL002BTE  
İletim frekansı: Fc=3.28 MHz

## İşitme cihazınız.

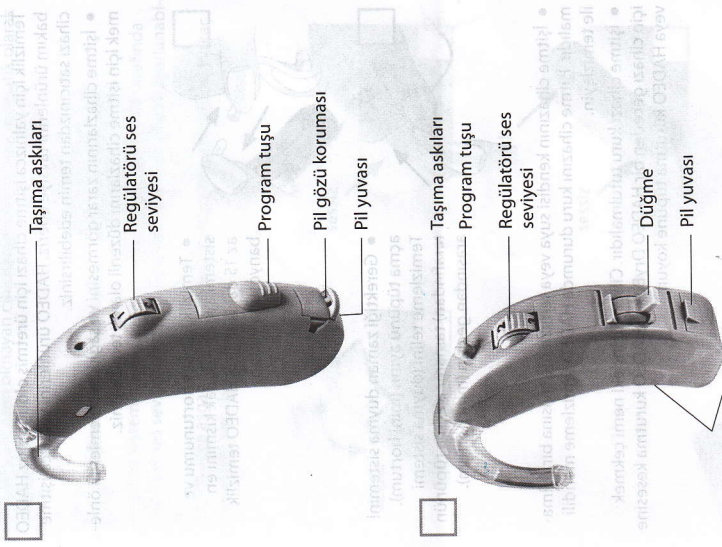

**CE** Avrupa Standartları Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği  
93/42/EEC hükümlerine uygunluğunu beyan  
0124 eder

## İşitme cihazımız.

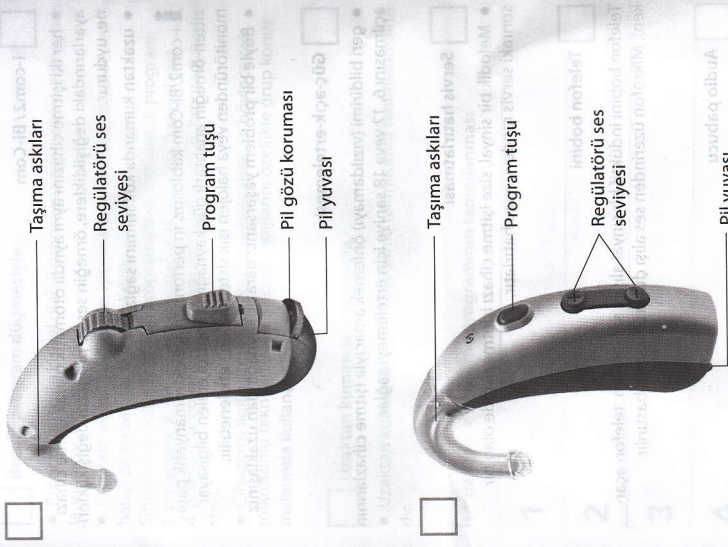

**Opsiyon: Açık (mini hortumu ile)**

**Opsiyon: Uzaktan Kumanda**

• Uzaktan kumanda ayrı bir kullanma talimatında tanımlanmaktadır.